



ขอแนะนำชุดตรวจ Rapid antigen test (ATK) COVID-19 จากบจก.พีเตอร์ เมดิฟาร์ จำกัด

1 ข้อความ

Rachaya Smart Science Co., Ltd <salest@smartscience.co.th>
 ถึง: info-news@tsu.ac.th

15 พฤศจิกายน 2564 11:28

เรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บริษัท พีเตอร์ เมดิฟาร์ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ชุดตรวจ ATK COVID-19 reOpenTest สำหรับตรวจหาเชื้อในโพรงจมูก มากับอุปกรณ์ครบชุด
 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพและได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) เลขที่ใบรับรอง ปท. 6400389

จุดเด่นของชุดตรวจ

- เป็นชุดตรวจโควิด-19 มีแบบ Home Use บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานที่บ้านได้อย่างปลอดภัย และมีแบบ Professional use ก้านยาวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
- รู้ผลตรวจไว้ใน 15 นาที ความแม่นยำสูงถึง 98%
- ภายในชุดประกอบด้วย ไม้สวอป, หลอดสกัดตัวอย่าง, น้ำยาสกัดตัวอย่าง, ดิสก์ชุดตรวจ และคู่มือการใช้งานภาษาไทย
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย CE Marked , ISO13485 , Germany P.E.I
- ผ่านการประเมินจากห้องปฏิบัติการ และใช้งานอย่างแพร่หลายในเยอรมนี สเปน เบลเยียม อังกฤษ เปรู เกาหลี เป็นต้น

มีจำหน่าย 3 แบบ ได้แก่

แบบที่ 1 : ชุดตรวจ 1 Test/กล่อง ชนิดไม้สั้น (Home use : Nasal Swab) บุคคลทั่วไปใช้เองได้

ราคาเริ่มต้น ชุดละ 90 บาท (100 ชุดขึ้นไป ชุดละ 80 บาท)

แบบที่ 2 : ชุดตรวจ 25 Tests/กล่อง ชนิดไม้สั้น (Home use: Nasal Swab) บุคคลทั่วไปใช้เองได้

ราคาเริ่มต้น กล่องละ 2,000 บาท (80 บาท/Test) (100 กล่องขึ้นไป กล่องละ 1,750 บาท (70 บาท/Test))

แบบที่ 3 : ชุดตรวจ 25 Tests/กล่อง ชนิดไม้ยาว (Professional use : Nasopharyngeal/Nasal Swab) แนะนำให้ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์

ราคาเริ่มต้น กล่องละ 2,000 บาท (80 บาท/Test) (100 กล่องขึ้นไป กล่องละ 1,750 บาท (70 บาท/Test))

**ทางบริษัทมีราคาลดพิเศษ สำหรับตรวจในปริมาณมาก

**ทางบริษัทยินดีส่งมอบ ตัวอย่างชุดตรวจให้ทดลองใช้ก่อนใช้งาน ฟรี

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคาชุดตรวจ สามารถติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อข้างล่างหรือตอบกลับอีเมลฉบับนี้ได้เลยคะ

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

ชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง



ปัจจุบัน ชุดตรวจได้รับความไว้วางใจ ใช้งานอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง



CHRISTIANI & NIELSEN



THE BALAI SCIENCE CENTER
CHULALONGKORN UNIVERSITY



CBAB
BUMSART UNIVERSITY



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย



ศิริเวช
Sirivej
มีน้ำใจ ทุ่มเทให้ลูกค้า



Jubilee
DIAMOND

Suzuden



HONDA



Perfect Service Solution



Asiametal
Public Company Limited

Thanks & Best Regards

Rachaya Leewanit (Bam), M.Sc. (Biochemistry)
Sales Executive & Specialist (Laboratory & Medical instrument)
E-mail: salest@smartscience.co.th
Tel: 061-3907870 Line ID: salesmartst

ADD FRIEND

Smart Science Group Companies
80/379 Moo3, Khlong Luang 26, Khlong Luang
Phatum Thani, Thailand 12120
Tel: 02-0777593 ext 101



จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
สารเคมี และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
TEL : 02-0777593
Email : sales@smartscience.co.th



Smart Science Co., Ltd.

- Hemomin Brand
- Chemicals for lab & industrial use
- Science Research Solutions



S Biotec Co., Ltd.

- Lab Instruments
- Lab Supplies



Peter Mediphar Co., Ltd.

- Medical Equipments
- Medical Supplies
- Active pharmaceutical ingredients (API)

SMART SCIENCE GROUP

เอกสารแนบ 5 ฉบับ



ใบอนุญาตชุดตรวจโควิด-19 reOpenTest บจก.ปีเตอร์ เมดิฟาร์ จำกัด.jpg
147K



เอกสารชุดตรวจโควิด-19 reOpenTest บจก.ปีเตอร์ เมดิฟาร์ จำกัด.jpg
206K



นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์_รชยา Smartsci (ภาคใต้).png
580K

ชุดตรวจ atk reOpenTest European certificated.png
674K



 brochure_atk reOpenTest_ Recommended in Europe.pdf
1737K



แบบ ป.ท.

ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์

ใบรับรองการประเมิน ที่ T 6400389

ใบรับรองการประเมินฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท สมาร์ท โซเลนซ์ จำกัด

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ใบจดทะเบียนที่กท. สน. 247/2562

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินเทคโนโลยี ตามมาตรา ๖ (๘)

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับเครื่องมือแพทย์

reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ รหัสสินค้า COVG10C, COVG10X, COVG10S

ขนาดบรรจุ 1 ชุดทดสอบ / กล่อง , 5 ชุดทดสอบ / กล่อง , 25 ชุดทดสอบ / กล่อง

ประเภทเพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ชนิดเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล แบบตรวจคัดกรอง

แบบตรวจหา แอนติเจนด้วยตนเอง (Home use/Self-test)

ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศ Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd.

2nd Floor, No. 3 Factory, No. 489 WenYun Road, TangPu Industrial Park,

Dipu Subdistrict, Anji County, HuZhou City, Zhejiang Province, China

ณ สถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อ บริษัท สมาร์ท โซเลนซ์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 80/379

द्रोक/खोय - ถนน หมู่ที่ 3

ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 โทรศัพท์ 0-2077-7593 โทรสาร -

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง

ผู้ซึ่งเลขา

และหัวหน้า



PM

Peter Mediphar Co., Ltd.

COVID-19 Antigen Rapid Test

ชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง

For patients suspected of current COVID-19 infection



COVG10G 1 Test kit/Box



COVG10S 25 Test kits/Box

reOpenTest



วิธีการใช้งาน

- ✓ เก็บตัวอย่างจากช่องจมูก
- ✓ ทราบผลใน 15 นาที
- ✓ ความแม่นยำสูง 97.52%
- ✓ ความจำเพาะสูง 99.13%



ราคาขายส่ง : ราคาตามจำนวน ดังนี้
(ราคา รวม Vat 7% แล้ว)


1. ชุด 1 Test Kit / Box

ขายส่ง	ราคา/ชุด
1-99	90 บาท
> 100	80 บาท

2. ชุด 25 Test Kits / Box

ขายส่ง	ราคา/กล่อง
1-99 กล่อง	2,000 บาท (80 บาท)
> 100 กล่อง	1,750 บาท (70 บาท)

Self-test Kit

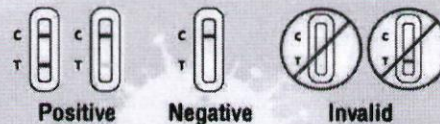

ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Marked

ชุดตรวจผ่านการรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใบรับรองการประเมินที่ T 6400389

Approved Authorities :



นำเข้าโดย : บริษัท สมาร์ท ไซออนซ์ จำกัด

จำหน่ายโดย : บริษัท ปีเตอร์ เมดิฟาร์ จำกัด

ฝ่ายขาย : รชยา (แบบ)

061-3907870, 098-8250970
02-0777593

salest@smartsience.co.th

ADD FRIEND



www.petermediphar.com

รชยา ลีวานิชย์ (แบบ)
Rachaya Leewanit (Bam)
Sales Executive

 **061-3907870**

 **Line ID : salesmartst**

 **salest@smartscience.co.th**

Smart Science Group Companies

**80/379 ม.3 ซ.คลองหลวง 26 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120**

**80/379 M.3 Khlong Luang 26. Phahonyothin Rd.
Khlong Nueng Khlong Luang. Pathum Thani.
Thailand 12120**

**SMART
SCIENCE
GROUP**



We provide scientific research, medical and pharmaceutical solutions.



หยุดเสี่ยง กับชุดตรวจฯ ไม่ได้มาตรฐาน

ใช้
reOpenTest

- ✓ ทราบผลใน 15 นาที
- ✓ ความแม่นยำสูง 97.52%
- ✓ ความจำเพาะสูง 99.13%



- ✓ ผ่านรับรองมาตรฐาน CE จากยุโรป
- ✓ ผ่านการรับรองจากแลปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
- ✓ ผ่านการรับรองจาก อย. T 6400389



Recommended
In Europe



Bundesinstitut
für Arzneimittel
und Medizinprodukte

Test-ID: A102/20

BfArM Listed

Paul-Ehrlich-Institut



Bundesinstitut für Impfstoffe
und Biomedizinische Arzneimittel

PEI Listed

CE

IVD



ISO 13485


www.petermediphar.com

LINE @petermed



02-077-7593

098-8250970, 087-8306909

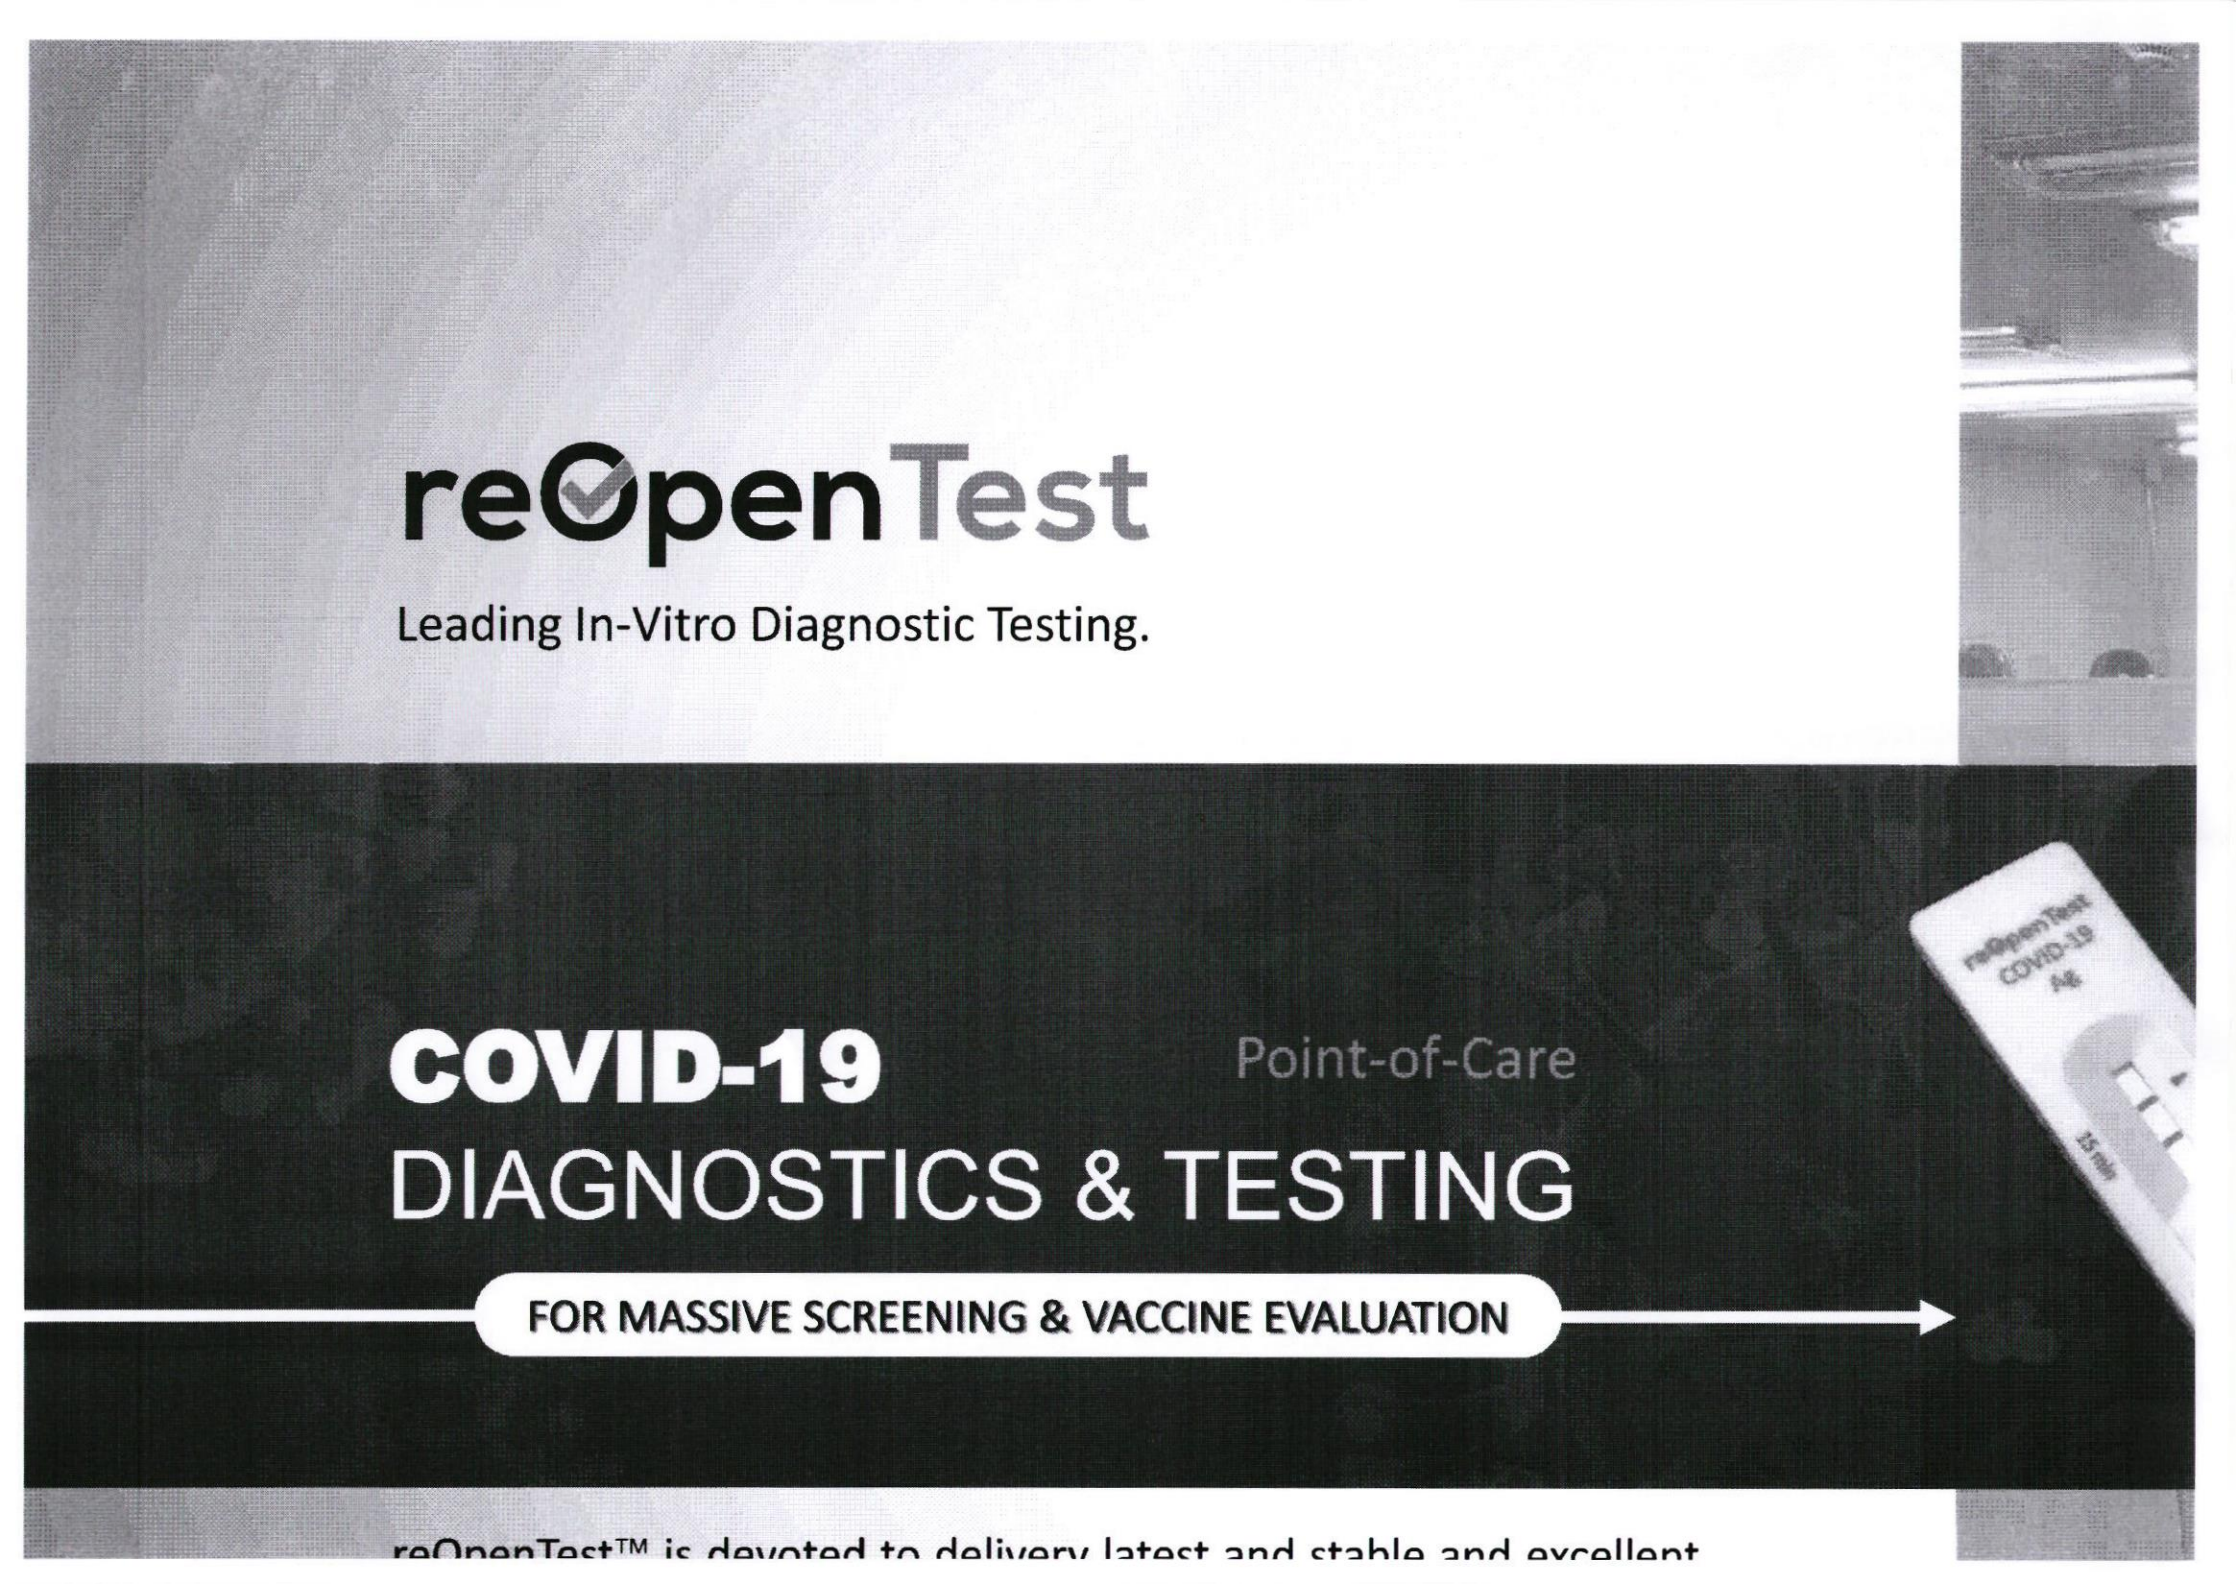


reOpenTest

Leading In-Vitro Diagnostic Testing.

COVID-19 Point-of-Care DIAGNOSTICS & TESTING

FOR MASSIVE SCREENING & VACCINE EVALUATION



reOpenTest™ is devoted to delivery latest and stable and excellent




Why Test For COVID-19?


- ✓ **To see if you need to be quarantined**
- ✓ **To plan your further treatment**
- ✓ **To protect others from COVID-19**



WEAR A MASK



STAY 6 FEET APART




AVOID CROWDS



GET A VACCINE

Based on the best practice of reOpenTest Use cases in Indonesia and other European countries.

When To Use

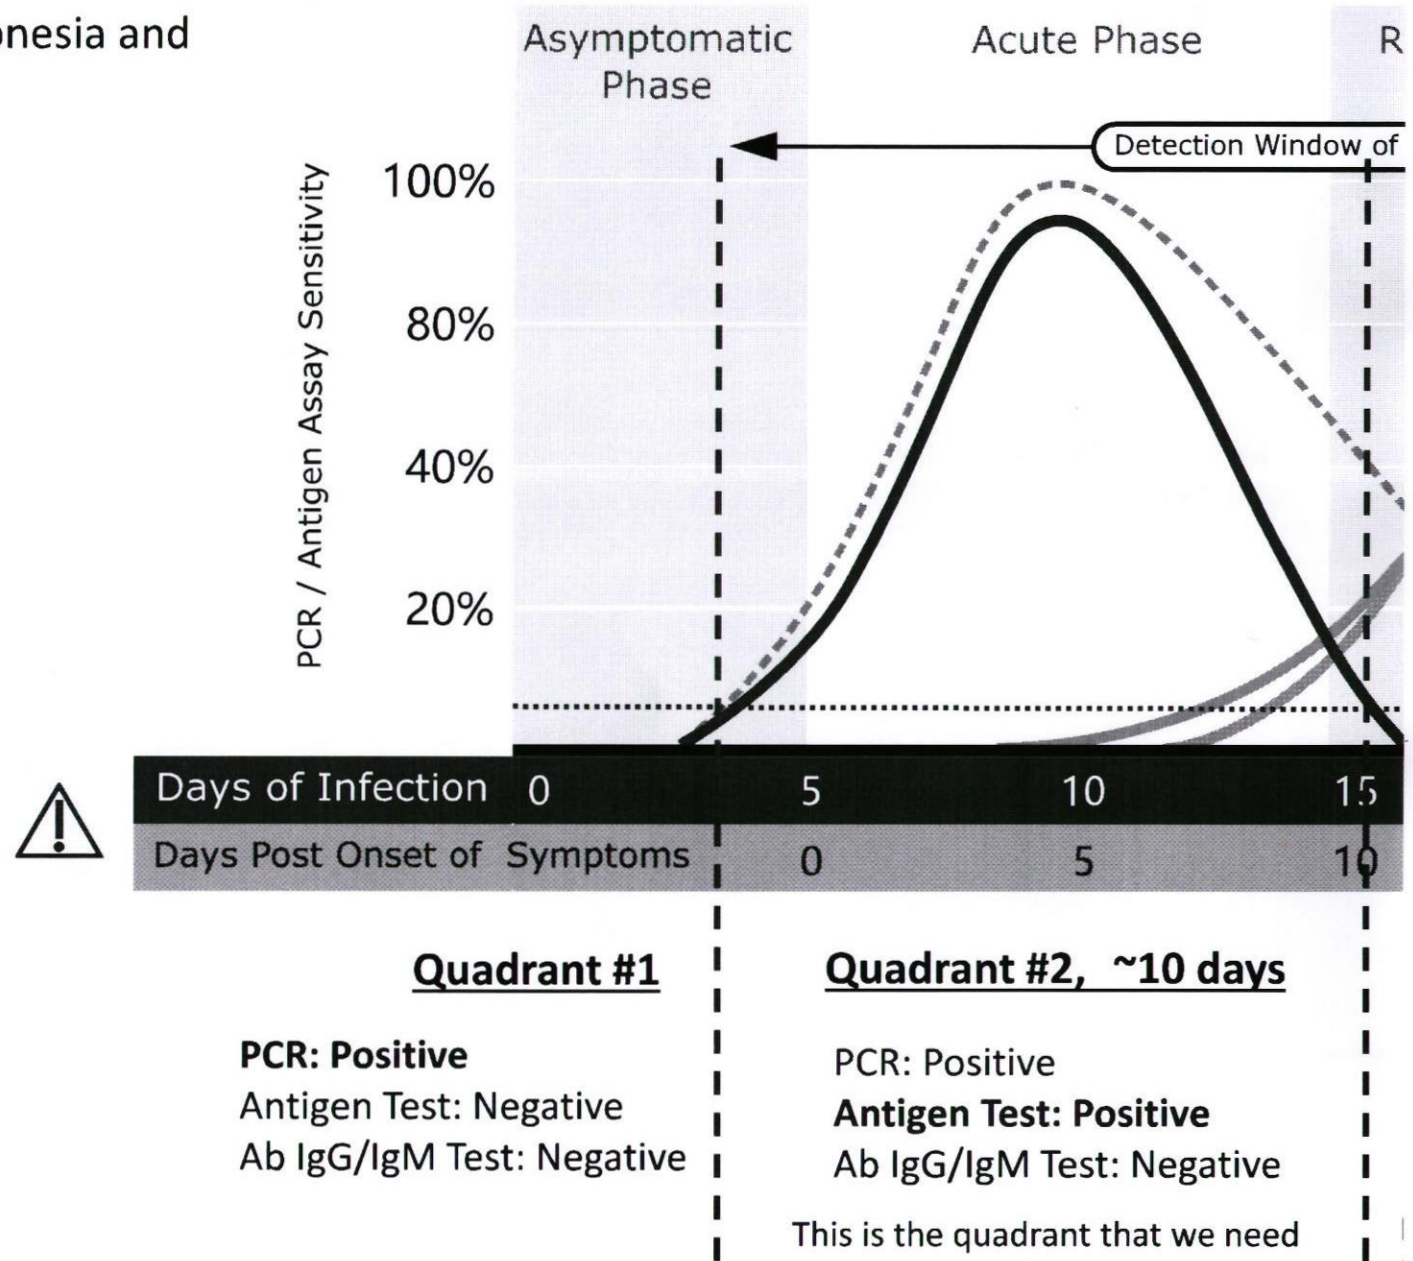

reOpenTest™

COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

REF COVG

For patients suspected of current COVID-19 infection

- Fast Results within 20 minutes
- Reliable, high performance
 - Sensitivity 97.52%
 - Specificity 99.13%
- Sample Type: Anterior Nasal Swab & Nasopharyngeal Swab
- Easy to use; No extra equipment required

REF

COVG10X 5 Test kits / Box;
1600 Tests/ Carton; Carton: 62x41x54cm; 28KG.

COVG10C 1 Test kit / Box;
450 Tests/ Carton; Carton: 54x36x33cm; 31KG




Recommended In Europe



Bunde
für Ar
und M

Test-I

BfArM

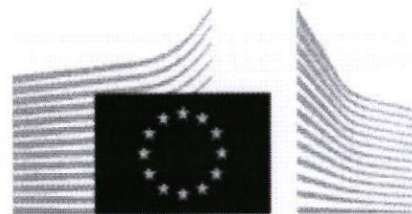

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

Public health, country knowledge, crisis management
Health Security

Manufacturer	RAT commercial name	CE marking	Clinical performance <i>Data by manufacturer</i>	Clinical performance <i>Data used in MS</i>	FIND evaluation studies	EU Member States using in practice	Other countries using in practice
Zhejiang Anji Saianfu Biotech Co., Ltd	reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test	Yes	95.8% sensitivity, Nasal swab	DE: Positive evaluation by Paul-Ehrlich-Institut (sensitivity of 94,1% at <Ct25) + Manufacturer specificity: 99%		DE ^[2]	

CE IVD

reOpenTest

COVID-19 Ag RDTs

Performance Comparison

	reOpenTest COVID-19 Antigen Rapid Test		STANDARD COVID-19 (SD Biosensor)
	4 th Generation	3 rd Generation	
Sensitivity	97.52%	95.8%	88.7%
Specificity	99.13%	99%	97.6%
LoD	(Cutoff) 1.00×10^2 TCID ₅₀ /ml	5.75×10^2 TCID ₅₀ /ml	7.14×10^2 TCID ₅₀ /ml

*LoD Data based on lab validation data from reOpenTest.com

*Data based on re

Listed in Germany P.E.I list

[https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsro](https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/Downloads/antigenrapidtest.pdf)

Paul-Ehrlich-Institut 

Reference Link: [h](#)
Update Date: Oct




CE

In alle verdere correspondentie betreffende bovvermelde producten verzoek ik u deze nummers te vermelden. Aan deze nummers kunnen ook verdere eichten

reOpenTest

Global Representative Office Contact

- Rep. & Available to sell
- Available to sell
- Looking for exclusive

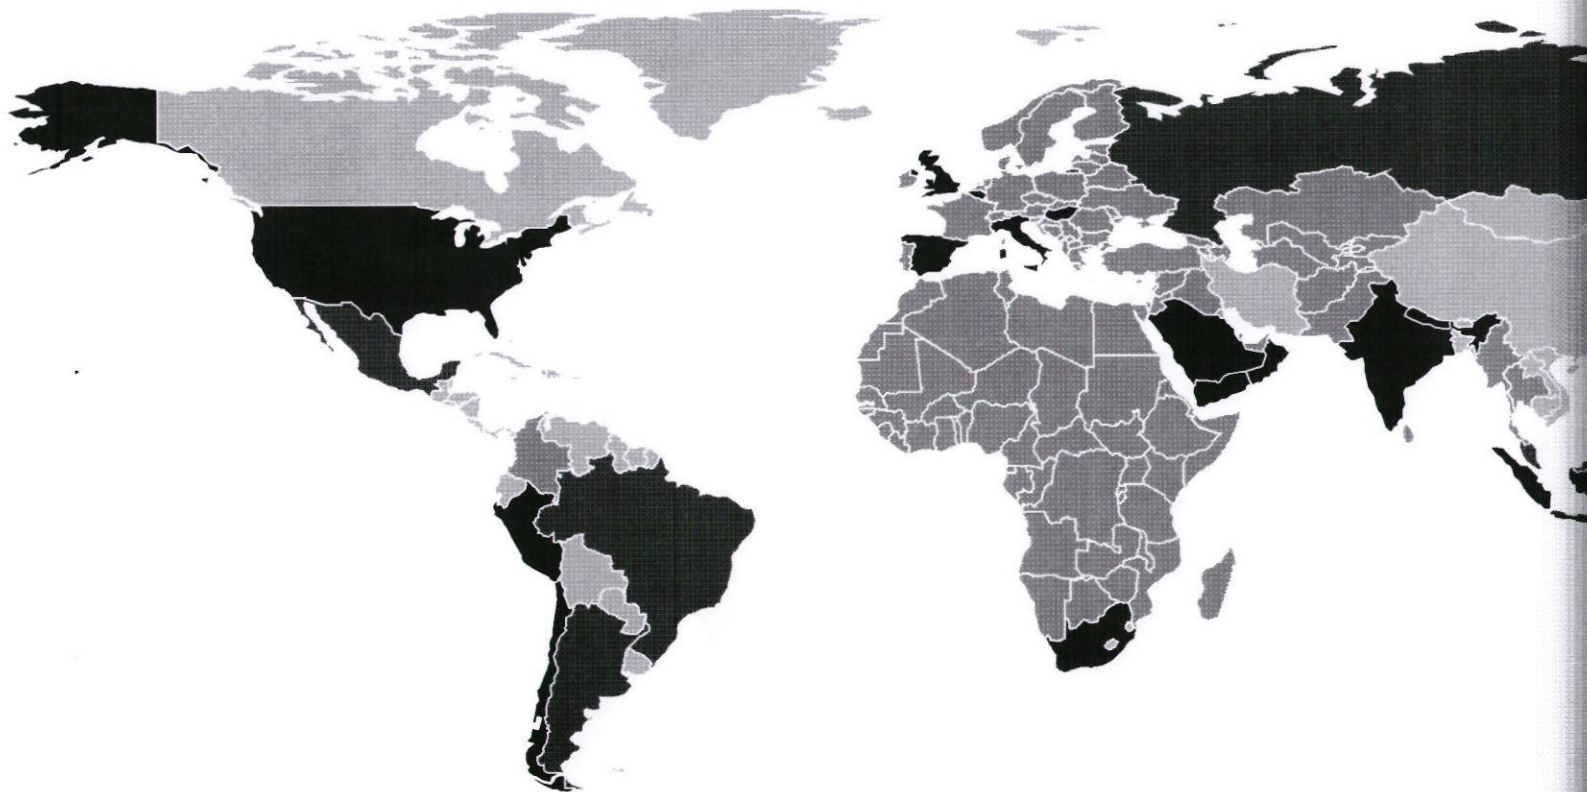

ORDER / 订购联系

国内联系: 毛经理
电话: +86-15381046223

Manufactured for:
Hangzhou Fenhe Technology Co., Ltd.
杭州分合科技有限公司

Manufactured by:
Zhejiang Anji Science Biotech Co., Ltd.

reOpenTest

12th, August 2020
Subject: Declaration of equivalence

To whom it may concern,

We undersigned, **Zhejiang A** headquarters in No.3 Factory county, HuZhou, ZheJiang, C comply with the origin criteria. The brand **reOpenTest™** exclusive rights in our product.

- Original: COVID-19 Anti Certificate: CE-IVD (NL-Link: <https://www.reopen>)
- Material: Uncut-sheet or



Yours sincerely,

reOpen Passport

Patients Online Reporting & Tracking



Patient Scan to Test

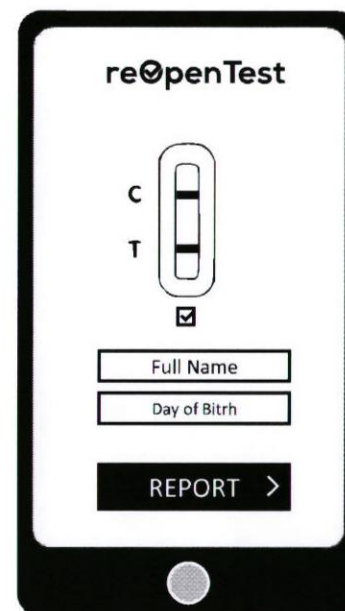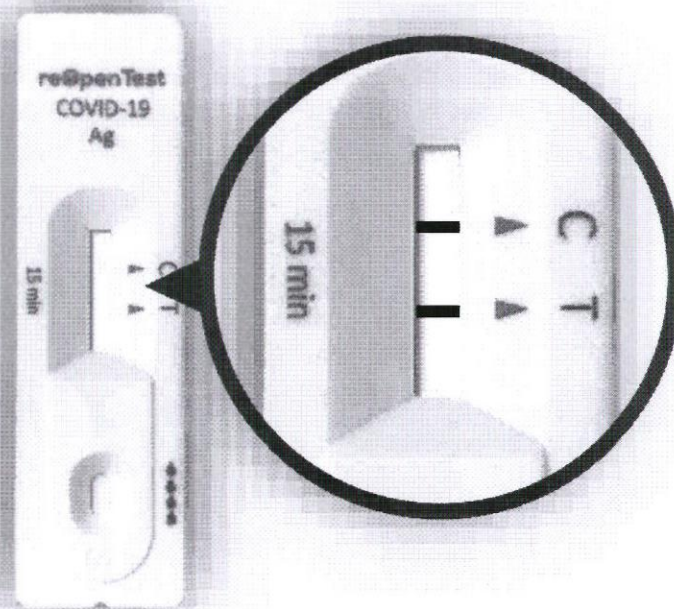

Negative

Team Manage Trial

• Login: <http://www.reOpenTest.coi>